

# 体征监护仪（WiFi版）


— 安装调试使用说明 —



LonBon 来邦 | 来邦科技股份公司



## 一、安装调试

体征监护仪安装在床头实时监测长者生命体征。产品通过专业传感器多维度采集长者的体征数据，包括心率、呼吸、离床等数据，实时上报至后台，并通过算法实时分析，出现异常能立即自动报警，提醒护理人员及时处理。

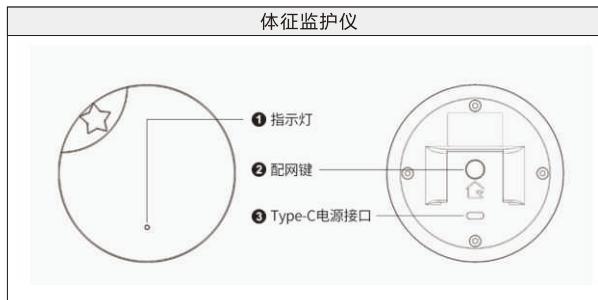

### 1、产品安装图

- (1) 设备支持两种安装固定方式：螺丝/3M 胶，且设备角度可根据实际场景进行调整。
- (2) 设备安装高度建议为距床面1-1.5米之间。

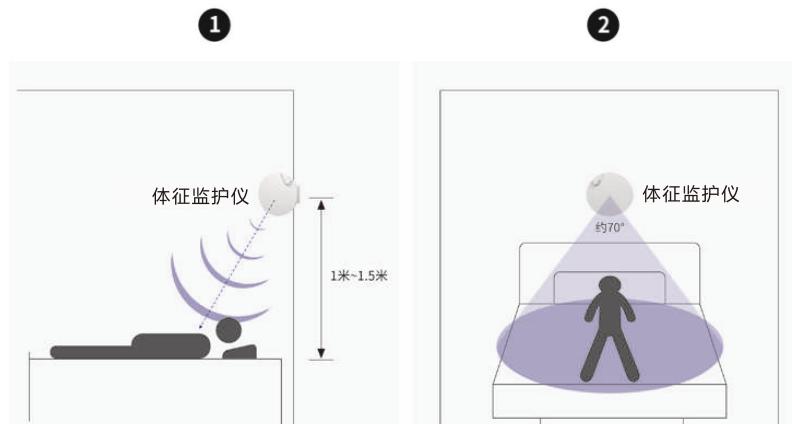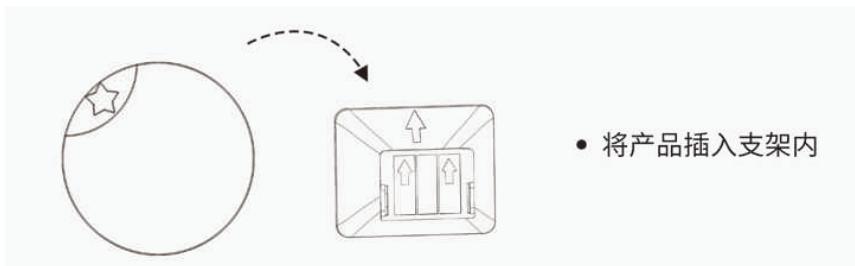

## 二、使用说明

### 1、注意事项

- (1) 一张床只能安装一个体征监护，且只能监测一人。
- (2) 此产品不适用于体内有金属支架或戴心脏起搏器的人群！
- (3) 使用此产品时，应保证按照安装要求进行安装，否则会导致监测不准确。
- (4) 此产品仅支持2.4G的WIFI网络，不支持5G频段。

### 2、设备绑定

- (1) 体征监护仪正常工作后，打开“机构养老” / “社区养老” App，进入“长者房间设备绑定”界面，选择需要绑定房间进入绑定设备(若无房间，请先在对应的管理平台上添加好房间)；
- (2) 下拉到床位设备，点击“请选择设备绑定”，在体征监护仪里点击“去绑定”，将手机尽量靠近体征监护仪，按照App上的提示进行按步骤即可完成绑定。

## 三、技术参数

通讯方式:	WiFi (2.4G)	供电方式:	适配器供电
供电接口:	Type-C	工作电压:	5V
工作温度:	-20°C~+50°C	工作湿度:	<80% (无凝结)
尺寸:	Φ98.5x20mm	重量:	100g

## 四、免责声明

本产品属电子产品，为用户提供睡眠监测等辅助作用，不作为专业医疗设备使用，不承担如设备断电断网、环境干扰、超出监测范围等情况造成的漏警、虚警引起的健康风险和法律责任，相关健康问题，请咨询专业医生。